



Kisa ki

Fibrilasyon Orikilè (AFib)?

Fibrilasyon Orikilè, oswa AFib, rive lè kavite sipèrye kè a, oreyèt yo, ap bat fason anòmal ak san kontwòl.¹


Batman Kè Nòmal

Men siyal elektrik nan yon batman kè nòmal.

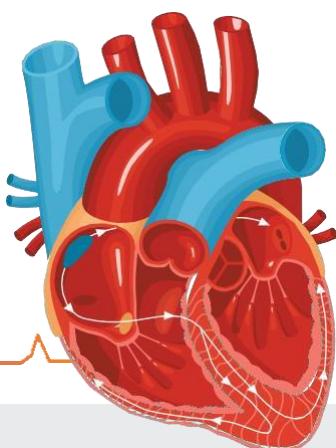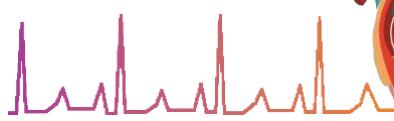

Fibrilasyon Orikilè

Fibrilasyon Orikilè ak yon siyal anòmal ki soti nan orijin chanm kè yo.

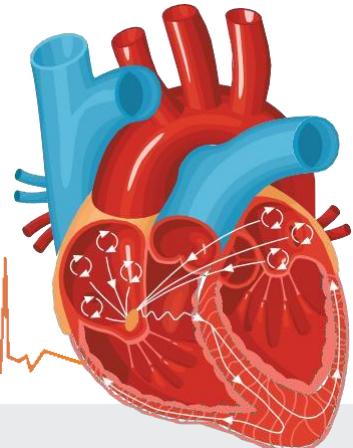

1 granmoun **sou 4**
plis pase 40 an
ris pou gen AFib

5X

Afib asosye **5 x ris**
estròk ak ensifizans
kadyak



Sentòm yo enkli fatig, vètij,
enkyetid, ak
kapasite redwi pou fè egzèsis

Tretman

Medikaman yo souvan bay kòm premye tantativ pou kontwole AFib.



50%

Apeprè 50% nan pasyan AFib pa reponn oswa tolere medikaman yo.³

Ablasyon Katetè



Ablasyon katetè se yon pwosedi ki pa deranje ki bloke pwoblèm siyal elektrik epi fè kè a bat nòmalman.¹

Kolèj Ameriken pou Kadyoloji ak Asosyasyon Kè Ameriken an rekòmande pwosedi a pou malad yo lè medikaman an bay rezulta.²

Si medikaman yo pa mache oswa provoke efè segondè negatif,
mande doktè ou si yon ablasyon pa katetè posib.


Ablasyon katetè se yon pwosedi anbilatwa ki pa deranje ki kapab:



Amelyore kalite lavi



Soulaje sentòm




Redwi ris pou fè estròk

Yo demonstre ke malad k ap resevwa ablasyon pa katetè yo gen jiska **73% plis chans pou yo pa gen sentòm** apre 4 an pa rapò ak malad ki resevwa tretman medikal.

Reprann Lavi Ou

Mande doktè w si ablasyon pa katetè se meyè opsyon tretman pou ou.

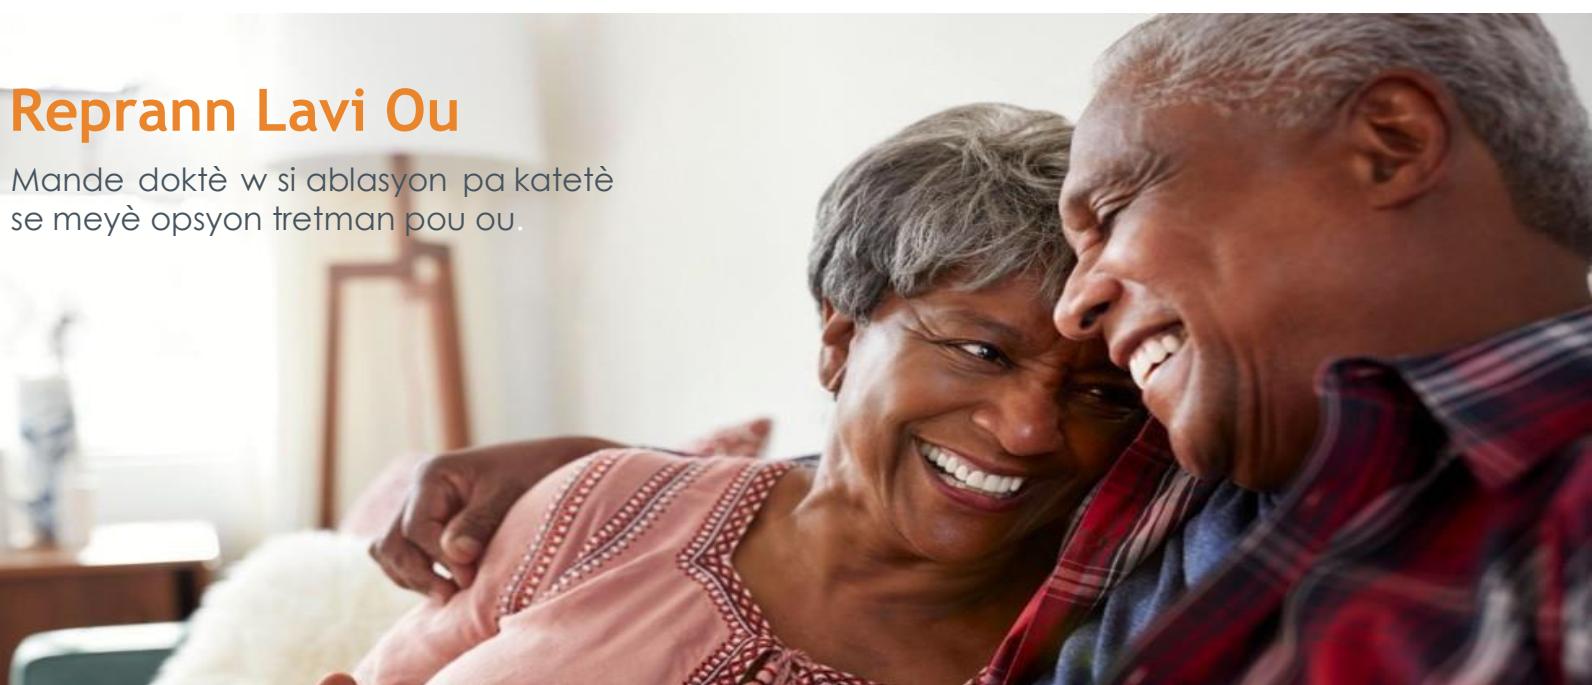

1. Mayo Clinic. Ablasyon Kadyak <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cardiac-ablation/about/pac-20384993?p=1>. Konsilte 6 desanm 2022

2. Hugh Calkins, Gerhard Hindricks, Ricardo Cappato, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/ SQAEC deklarasyon konsansis ekspè sou ablasyon katetè ak ablasyon chirijikal nan fibrilasyon orikilè. Batman Kè 2017.

3. Calkins H, Reynolds R, Spector P et al. Tretman Fibrilasyon Orikilè ak Medikaman Anti-batman oswa Ablasyon RF. Sik. Aritmì ak Elektrofiziòl. 2009.

Menjan ak nepòt tretman medikal, rezulta endividye yo ka vareye. Se sèlman yon kadyalòg oswa elektrofiziyalòjis ki ka detèmine si ablasyon se yon tretman appropriye. Gen risk potansyèl tankou senyen, anfie oswa ematòm nan sit ensèsyon katetè a, ak enfeksyon. Konplikasyon ki pi grav yo ra, ki ka gen ladan domaj nan kè a oswa vesò sangen yo; boul nan san (ki ka mennen estròk); atak kè, oswa lanmò. Risk sa yo bezwen diskite ak doktè ou epi rekiperasyon an pran tan. Siksè pwosedi sa a depann de anpil faktè, tankou kondisyon fizik ou ak kapasite kò ou pou tolere pwosedi a. Chwazi ak swen nan doktè ou yo ak lopital la, sou konpetans yo ak eksperians yo.

Katetè THERMOCOOL SMARTTOUCH® SF endike pou tretman fibrilasyon orikilè (FA) paroksistik sentomatik rekiran refraktè ak fibrillation orikilè (FO) ki gen yon pèsistans sentomatik refraktè nan medikaman (FA kontinu > 7 jou men < 1 an), refraktè oswa entolerans nan omwen 1 AAD klas I oswa III AAD, lè yo itilize i ak Sistèm CARTO® 3 a.

Enfòmasyon Enpòtan: Anvan tout itilizasyon, gade nan konsilte mòd anpilwa a ak aparèy sa a pou konn endikasyon yo, kont-endikasyon yo, efè segondè, avètisman ak prekson. Atansyon: Lalwa Elazini mete restriksyon sou aparèy sa a pou vann pa oswa sou lòd yon doktè

Biosense Webster, Inc.

31 Technology Drive, Suite 200 Irvine, CA 92618

USA Tel: +1-909-839-8500 Tel: +1-800-729-9010

www.biosensewebster.com

©Biosense Webster, Inc. 2023 255019-230727